
Digora Optime kuvanlukija
- jumittuneen kuvakkeen poisto



1. Irrota Optime kuvanlukijan takaa musta virtajohto
2. Laitteen takana yläkulmissa 2kpl ruuveja joita avataan n. 20 kierrosta ja tämän jälkeen ruuvit painetaan voimakkaasti sisään. Huom! Älä avaa ruuveja kokonaan.
3. Nosta kansi suoraan ylös. Huom! Kun laitat kannen takaisin älä kiristä liikaa takana olevia kannen kiinnitysruuveja, sormitiukkuus riittää ruuveille.
4. Irrota suojapelti irrottamalla kuvassa näkyvät 3 mm ruuvit 2kpl. Nosta mutta suojapelti pois käännä hieman peltiä ohi ruuvien, jotka estävät peltiä nousemasta suoraan ylös.
5. Käännä hihnapyörästävarovasti pyörittäen kelkka pois edestä. Kelkka palautuu ensimmäisellä käynnistys kerralla oikeaan kohtaan.
6. Poista pahvi tai kuvalevy esim. atuloita apuna käyttäen. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä

127

Intraoraali röntgen laitteiden QA
- huone 1 ja huone 2 tehdään erikseen: 1 x/ 6kk



1. Minray intraoraali röntgen laitteisto löytyy molemmista hoitohuoneista
   - Testikappale Test Tool Digital, Type: TTD, Ser No: 1210164 säilytetään OPTG huoneessa, kuvanlukijan alla
2. Kuvataan, Testipotilas Tauno pot nro 7, alaincisiivin kuvauschjelmalla
3. Kuvaputki kiinni testikappaleeseen, kuvalevyke pohjassa testikappaleen aukossa
4. Laadunvalvontakuvaus on hyväksyttykun röntgen kuvassa näkyy 4 palloa ja toiseksi pienimmät viivat erottuvat toisistaan.

128

Orthophos SL
- 2D JA 3D CONSTANCY TESTS – 1x/ KK, raportit mapitetaan



129

Orthophos SL – eri testikuvauskappaleet

2D – "Neula"testikappale:
Käsittele varoen, rikkoutuu helposti, kallis


3D – testikappale
Käsittele varoen, kallis



130

Orthophos SL
- 2D CONSTANCY TEST – 1x/ KK

Avaa Sidexis 4 röntgen ohjelma:

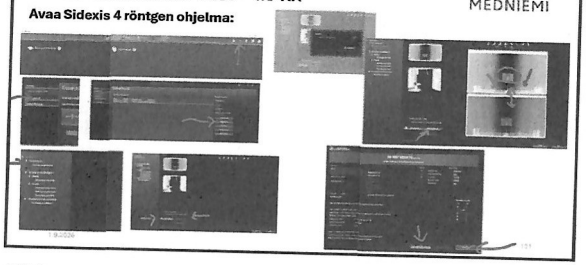

131

Orthophos SL
- 3D CONSTANCY TEST – 1x/ KK

Avaa Sidexis 4 röntgen ohjelma:
Tee kuten 2D kunnes valitaan 3D



132

Hoitotoimenpiteiden haltuunotto

Hoitotoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joita toistetaan muunnellusti

- **Kariologia = hampaiden reikiintyminen -> paikkaus**
- **Protetiikka = hampaiden korvaaminen suun ulkopuolella valmistetuin osin**
  - **Kiinteä protetiikka -> osakruunut, kruunut, sillat**
  - **Irtoprotetiikka -> osaproteesit, kokoproteesit (=tekarit)**
- **Endodontia = hampaiden juurihoito**
- **Ortodontia = oikomishoito**
- **Kirurgia**

133

Työpisteiden haltuunotto

Joka työpisteellä on oma toimikuva:

1. **Hoitohuone 1**
2. **Välinehuolto**
3. **Vastaanottotiski/ odotustila**
4. **Hoitohuone 2**
5. **Keittiö**
6. **Cerec jyrsintäkeskus**
7. **Röntgen huone**

134

Ohjelmistojen haltuunotto

Käytössämme on tietokonejärjestelmät:

1. Mikrosoft Office
2. Helmi
   - potilastietokanta puoli
   - kirjanpito puoli
   - Kela-liitys yhteys ja korvausten hakeminen
   - Nettiajanvaraus
3. Röntgen ohjelmistot
   - Digora: vanhat röntgen kuvat
   - Sidexis: Röntgenhuoneessa otettavat 2D panorama kuvat ja 3D kuvat ja hoitohuoneessa otetta pikkukuvat
4. Skanneri:
   - Cerec PrimeScan1
5. DS Core
   - Pilvipalvelu, josta skannaus aloitetaan ja johon skannaus menee

135