Anthos L9 Unitti
- henkilöprofiili, omat tuoliasetukset

MEDNIEMI



145

Anthos L9 Unitti
- Restorative


MEDNIEMI



146

EMS-torni: UÄ ja jauhepuhdistin
- voi käyttää vain huoneessa 2

MEDNIEMI

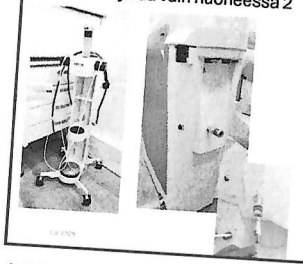

- EMS-torni vaatii paine-ilman, unitissa metallinen liitin
- Kun yhdistät tai irrotat EMS tornin, tyhjennä unitti paineilmasta ensin – vähemmän vastusta!

147

EMS-torni: UÄ ja jauhepuhdistin
- voi käyttää vain huoneessa 2

MEDNIEMI




- EMS-tornin jalkakytkin langaton, on AA pattereilla toimiva
- ?
- ?
- ?
- ?

148

EMS
- käyttöohjeet


MEDNIEMI

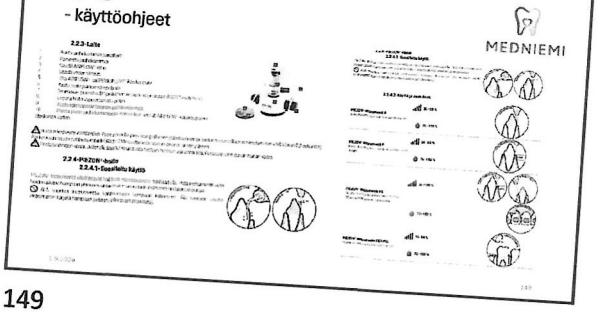

149

EMS käyttö- ja hoito-ohjeet

MEDNIEMI

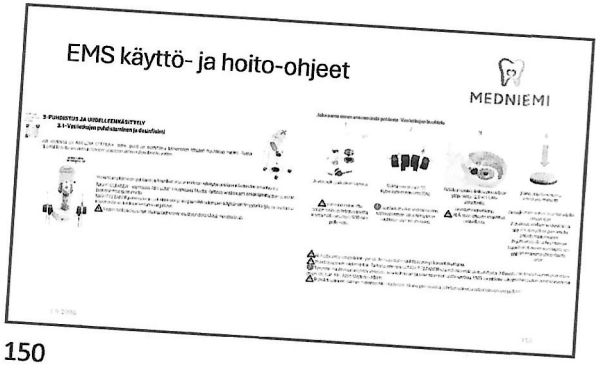

150

EMS käyttö- ja hoito-ohjeet


MEDNIEMI



151

EMS käyttö- ja hoito-ohjeet


MEDNIEMI

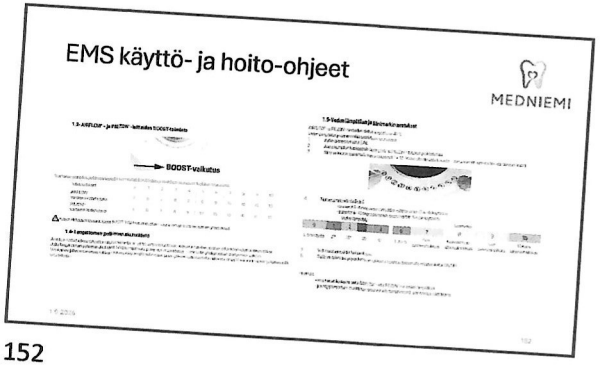

152

EMS käyttö- ja hoito-ohjeet

MEDNIEMI

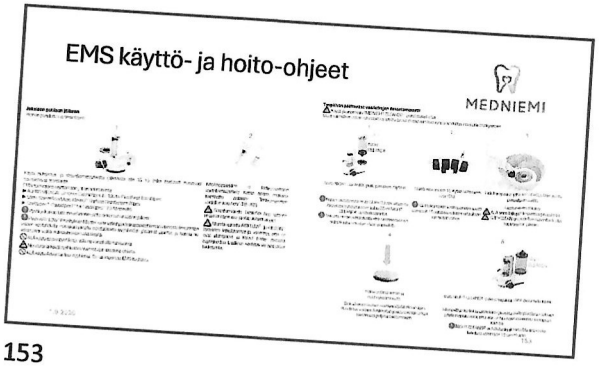

153